

Bruksanvisning

KANMED^o BABYBED



Art no: BB100-080 NO vers. 6
2021-11-23

Advarsel

Les denne manualen nøye før bruk.
Feilaktig bruk av sengen kan
eventuelt skade patient og bruker.



Produsert av:

Kanmed AB
www.kanmed.se

Denne bruksanvisning gjelder for alle Kanmed BabyBed som har blitt levert siden 2017
Siste versjon av bruksanvisningen finner du på www.kanmed.se under downloads.

Innholdsfortegnelse

1 BRUKSOMRÅDE	3
2 ADVARSLER	3
3 FORKLARING AV SYMBOLER.....	4
4 INSTRUKSJON FOR BRUK	5
5 RENGJØRING	9
6 PERIODISKE KONTROLLER FØR BRUK	10
7 FEILSØKING.....	10
8 TEKNISKE DATA	11
9 TECHNICAL SECTION - SERVICE AND MAINTENANCE.....	12
10 TILLBEHØR /RESERVEDELER	14
11 GARANTIER	16
12 EMC INFORMATION	16
13 KASSERING.....	16

BB101 standard uten rails



BB100 standard med rails



BB400 Tvilling med rails



BB102 Standard med metallskinner



1 Bruksområde

Bruksområde


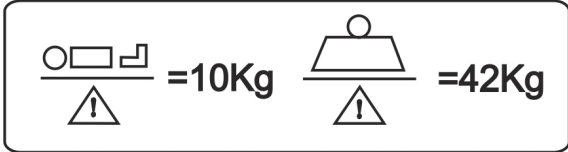











Kanmed Babybed er en ergonomisk og sikker stelleseng for nyfødte og for tidlig fødte barn på sykehus. Kanmed BabyBed er også beregnet for bruk sammen med Kanmed BabyWarmer BW3 og BabyWarmer-50

Kanmed BabyBed skal brukes av sykehusets pleiepersonell eller av barnets foreldre ifølge de instruksjoner som finnes i denne bruksanvisningen og ifølge sykehusets kliniske rutiner. Kanmed Babybed skal bare brukes av personer som har fått nødvendig opplæring i sikker bruk.

2 Advarsler

- Bruk aldri Kanmed Babybed til barn som er så store at de kan bevege seg/klatre slik at de kan falle ut av sengen.
- Kontroller at sideveggene er riktig plassert, og at de er sikret i i øverste stilling dersom barnet forlates uten tilsyn.
- Flytt ikke rundt når den står i øvre posisjon. Forsøk alltid å senke den til laveste stillingen ved transport.
- Bruk ikke sideveggene ved flytting av sengen. Bruk sidehåndtakene.
- Forlat aldri barnet uten tilsyn når sideveggene er senket.
- Respekter vektgrensene som er angitt i denne bruksanvisningen.
- Plasser ikke elektronisk utstyr på hyllen under sengen.
- Kontroller att sengen er stabil, og at alle hjul og bolter er festet.
- Ved justering av sengens høyde må det kontrolleres at ingen ting er i veien.
- Fjern teltstangen dersom telt ikke er i bruk.
- Teltstangen er kun beregnet for telt.
- Dersom barn, slektninger eller pasienter med spesielle behov kan tenkes å trykke/leke med fotpedalen for høyderegulering, skal nettstøpslet trekkes ut. Kontroller at evt. Kanmed Babywarmer får strøm.
- Hold sikker avstand til andre produkter som kan senkes/heves.
- Maksimal tykkelse på madrassen er 40 mm
- Bare personer som har fått nødvendig opplæring i bruk skal bruke Kanmed Babybed.

3 Forklaring av symboler

	Les bruksanvisningen		
Tilgjengelige modeller:			
BB100	Standard BabyBed	BB101	Samme men uten skinner
BB400	BabyBed for Tvillinger	BB401	Samme men uten skinner
BB300	Standard BabyBed fast høyde	BB301	Samme men uten skinner
BB400F	BabyBed for Tvillinger med fast høyde	BB401F	Samme men uten skinner
BB102	Standard med metallskinner	BB402	Tvilling med metallskinner
Høyeste tillatte sikre belastninger:			
			
Sengebalje, alle modeller: Barnets(barnas) totale vekt 10 kg + vannmadrass(er), Gel madrasser eller andre madrass typer, total 10kg Hylle: Maks 5 kg Hylle over skuff under sengen: 2kg Skuff under sengen: 2kg Sidehåndtak: Maks 3,5 kg per side. Totalt 10 kilo på sidehåndtak tilsammen.			
	Symbol på fotpedalen for å heve og senke sengen (ikke for BB300, 301 og BB400,401F).		
	Symbol for tiltfunksjon, plassert på sengebaljens høyre side.		
	Oppfyller EU 2017/745 (MDR) og 2011/65/EU (RoHS).		
	Indikerer at varen er et medisinsk utstyr.		
	Jordpotensialklemme.		
IP 30	Kapslingsgrad		
	Beskyttelsesgrad Type B (Body) (ikke for BB300.301 / BB400F, 401F)		
	Når sengen skal kasseres skal den leveres til gjenvinning ifølge direktiv EU 2002/96/EC (WEEE).		
 20XX	Produksjonsår.	 9min/h	Maksimal tid som løftemekanismen kan kjøres pr. time
 88 Kg	Omtrentlig totalvekt av seng når den er lastet med maksimal tillat vekt.		
	Klemrisiko		

4 Instruksjon for bruk

4.1 Første rengjøring

Kanmed BabyBed og tilbehør er rene ved levering, men må rengjøres ifølge sykehusets rutiner før bruk med pasienter.

Se seksjon 5 Rengjøring

Se seksjon 5 for montering og demontering av sidevegger.

4.2 Kontroller stabilitet

Kontroller at sengen er stabil og at alle hjul og bolter er festet.

4.3 Senke og heve sidevegger.

Sidevegger og frontvegg senkes på følgende måte:


Ta tak i veggens overkant med begge hender

Løft veggene opp ca ½ cm. Trekk den mot deg ca 2 cm og trykk den forsiktig nedover. Bruk begge hender for å trekke den opp til den stopper, trykk litt fremover og deretter litt ned slik at den låser seg.

Kontroller at veggene glir lett og at de er uskadde.

OBSERVER: Kontroller at ingen ting er i veien når du senker eller hever veggene.

OBSERVER: Se avsnitt **Rengjøring** for informasjon om hvordan veggene demonteres.

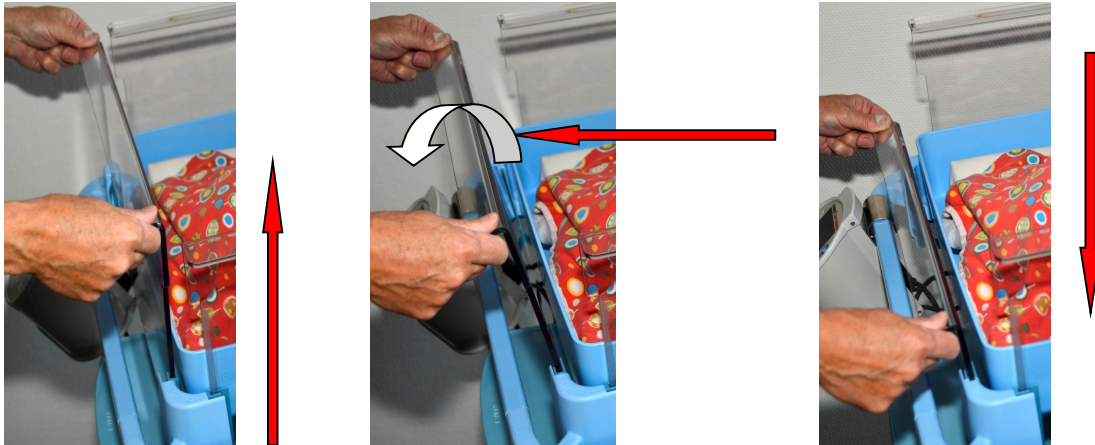

4.4 Forflytting av Kanmed BabyBed

Bruk alltid sidehåndtakene eller fronthåndtaket.

ADVARSEL: Senk sengen til laveste høyde når den forflyttes, spesielt når det ligger barn i den.

OBSERVER:

- Ikke hold i veggene ved forflytning.
- Husk å fjerne alle kabler etc. før flytting av sengen.
- Bruk hjulbremsene når sengen er på plass.

4.5 Tilkobling av Kanmed BabyBed till nettstrøm

(Ikke for BB300, 301 og BB400F, 401F)

Kanmed BabyBed må tilkobles et jordet nettuttak med en korrekt jordet kabel.

OBSERVER: Den eneste måten du kan bryte strømmen, er å trekke ut kabelen fra vegguttaket eller fra sengen. Plasser sengen slik at du enkelt kan nå kabelen. Plasser kabelen slik at ingen snubler i den.

ADVARSEL: For å unngå risiko for elektrisk støt må sengen alltid tilkobles et jordet nettuttak.



4.6 Høydejustering

(Ikke for BB300, 301 og BB400F, 401F)

Høyden justeres med fotpedalen.

Tilkoble til strøm, og kontroller at sengen beveger seg uten unormale lyder.

Motoren høres tydelig – dette er et varsel om at sengen beveger seg.

Fotpedaler kan monteres på venstre eller høyre side eller på begge sider. Frontpedal er også tilgjengelig



ADVARSEL:

Når du endrer høyde må du kontrollere at ingen person, kabel eller noe annet er i veien, at ingen kabel henger i løftesøylen eller andre steder.

Tenk to ganger og trykk en gang!


- Dersom barn, slektninger eller pasienter med spesielle behov kan tenkes å trykke/leke med fotpedalen for høyderegulering, skal nettstøpslet trekkes ut. Kontroller at evt. Kanmed Babywarmer får strøm.

Blokkør ikke løftesøylens bevegelse når du forandrer høyde.

4.7 Tilting av seng

Når du vil tilte sengen tar du tak i begge hjørnene og trykker på utløserknappen på høyre side samtidig som du stiller inn ønsket grad av tilting. Slipp utløserknappen. Kontakt Med.tekn. avd. dersom du ønsker å redusere maksimal vinkel.

Et sett er tilgjengelig for å oppgradere tiltfunksjonen til + og - 17 grader, Trendelenburg posisjon. Art no BB173.

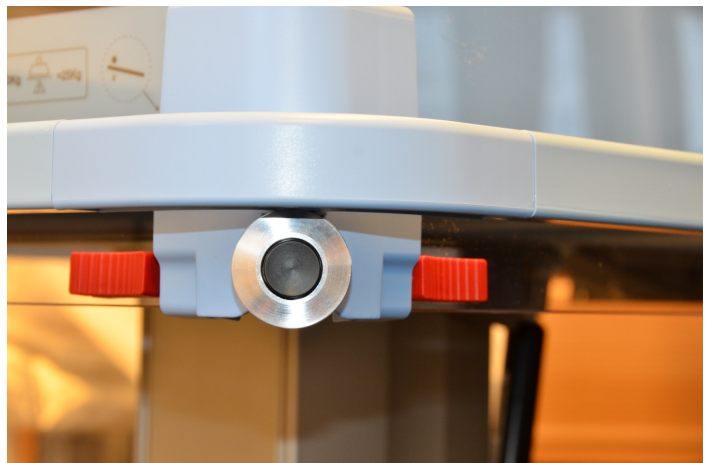

Tilt utløserknapp på modeller med sideskinner.




Tilt utløserknapp på modeller uten sideskinner.

4.8 Teltstang, telt og madrass.

Sett fast teltstangen i det bakre beslaget.
Hold den vinkelrett slik at skruene passer i styringssporet.
Teltet har en innsydd kanal for å holde det på plass.
Teltsiden legges utenfor sideveggene.
Legg madrassen i sengen.
Bruk av andre madrasser og telt kan endre Kanmeds produktansvar.

MERK: Teltpolen har 2 høydeposisjoner.
Pass på at du bruker riktig teltstang.




Stop skruenposition B100/101/300/301

Stop skruenposition tvillingseng

4.9 Sengebjelje

Ved å ha sengebrettet løst kan du løfte det ut for enkel rengjøring og for rengjøring av sengeplattformen også.

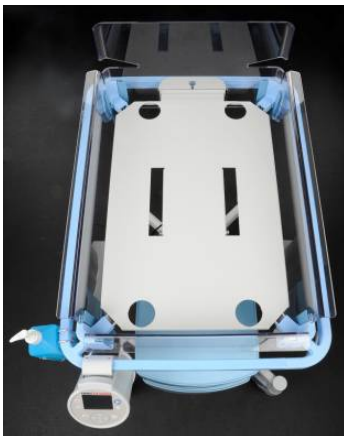

4.10 Skuffer

Skuffer, med eller uten lokk, kan monteres på løftesøylen.
Maks 3 stk.
Skuffer og lokk kan svinges ut til begge sider, og holdes på plass i midtstilling.
Respekter vektbegrensningene som er 2 kg for skuffen, og 2 kg for lokket.




4.11 Kanmed BabyWarmer

Kanmed BabyWarmer Control Unit er vanligvis plassert på en stang under sengen og festes med sin justerbare brakett.

Det er andre måter å montere Kanmed BabyWarmer på Kanmed senger.

Vennligst se www.kanmed.se, BabyBed, downloads, dokumentet kalt "Possible ways to mount...".

Kabelen for varmeelementet bør føres gjennom hullet i bunnen av sengebalken.

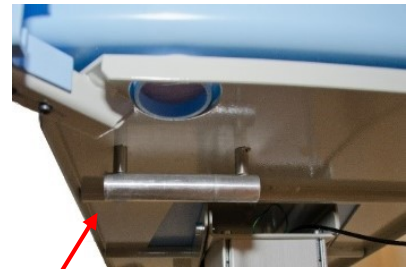

4.12 Kanmed BabyWarmer kabel

Kanmed BabyWarmer kontrollenhet tilkobles til lysnettet med egen kabel, eller med en kort spesialkabel som tilkobles på løftesøylen.

Se bilde. (Art.nr. Nummer 800-0502, spesialkabel)
Les Kanmed BabyWarmer bruksanvisning for ytterligere informasjon.



4.13 Brakett for infusjonsstativ/drenasje

Alle nyere senger er utstyrt med en bakre festebrakett. Se bilde.

Rør med skruer er tilbehør og er standard 25 mm diameter rustfritt stål rør.

Bestillingsnumre finnes i Seksjon 10

Maks vekt på hver stolpe: 3 kg




4.14 Hylle i stål

En hylle kan bestilles i stedet for oppbevaringsboksene.

Art nr: 800-0530 med 3 cm høye kanter bilde til høyre

Art nr:800-0540 med 5 cm høye kanter

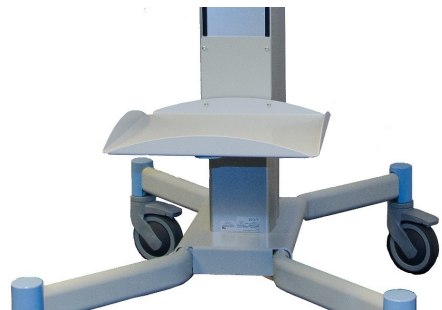

4.15 Annet tilbehør

Kanmed tilbehør monteres ifølge den instruksjon som medfølger tilbehøret.

Respekter vektgrensene som oppgis i seksjon 3

Montering av annet utstyr kan gjøres, men det må tas hensyn til vekt etc.

Kontakt Avalon Medical for råd.

Kanmed er kun ansvarlig for det utstyr som leveres fra Kanmed.

Se www.kanmed.se for informasjon om tilgjengelig tillbehør.

5 Rengjøring

Allmen informasjon

Kanmed BabyBed skal rengjøres nøye mellom hver pasient. Følg forøvrig sykehusets renholdsprosedyre for rengjøring og desinfeksjon av denne type utstyr. Kontroller at alle deler er i orden før og etter rengjøring.

Nedenfor følger en anbefalt liste over desinfeksjonsmidler som kan brukes. Overdrevet renhold kan minske levetiden til enkelte deler. Kontakt Kanmed om du har spørsmål om rengjøring. Alle sidevegger er produsert i PET, et materiale som tåler de fleste kjente rengjøring- og desinfeksjonsmidler. Bruk ikke løsningsmidler som f.eks. Aceton.

Rengjøring: Bruk såpe og vann.

Desinfeksjon: Kanmed BabyBed tåler de vanligste desinfeksjonsmidler, f.eks. Virkon®, Diversey Limpiador Colorado, Clinell savietter, Chlor Clean savietter, Meliseptol® rapid, Dax, Terralin®, Dsimozon® pur, perform® DES +45 og lignende. Er du i tvil bør du teste på en "ikke viktig" flate eller kontakt Kanmed.

DETALJINFORMASJON

5.1 Rengjøring



Bruk fuktige kluter.
OBSERVER: Kanmed BabyBed må aldri spyles.
Bruk ikke desinfeksjonskammere.

5.2 Sengebalje

Sengebaljen kan løftes ut for å forenkle rengjøring. Dette gir også god tilgang til sengeplattformen.

5.3 Rengjøring av sidevegger

Slik tar du ut sideveggene:
Skyv de røde låsene mot midten.
Nå kan sideveggene trekkes opp.
Vask ikke sengene i vaskemaskin.
Bruk ikke kluter eller annet materiale som kan lage riper.

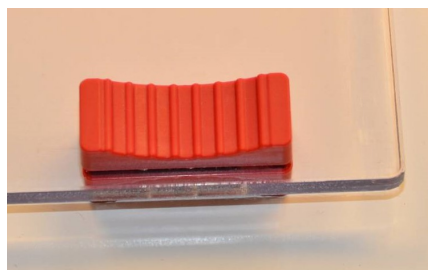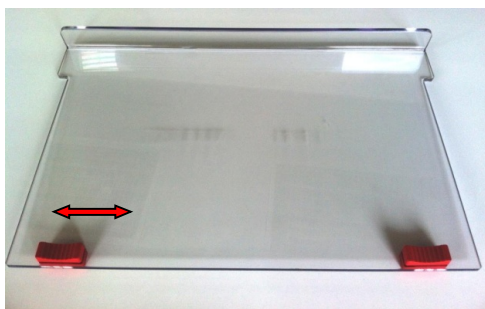

5.4 Sett sideveggene tilbake

Skyv sideveggene på forsiktig på plass og trykk Røde stopper utover. Foldet øvre kant av sidevegget skal vende utover.

5.5 Skuffer, lokk og hylle

Skuffer og lokk rengjøres på samme måte som resten av sengen.

5.7 Madrass

Rengjøres som resten av sengen.

5.8 Telt

Se etiketten for vaskeanvisning

Dersom teltet trenger ekstra rengjøring, kan det vaskes i 90 grader C. Vask i 90 grader kan medføre krymping og kortere levetid.

6 Periodiske kontroller før bruk

Allment

Kontroller at alle deler er feilfrie, og at de ikke har sprekkdannelser. Bytt deler som ikke er i god stand. Årlig kontroll skal utføres av Medisinsk-teknisk personell. – se teknisk seksjon.

Anbefalte kontroller før bruk.	Utføres av	Intervall	Ytterligere informasjon
Sideveggenes funksjon	Bruker	Før bruk	Kontroller at sideveggen kan heves og senkes uten problem, og at de låser i øvre posisjon.
Tilting	Bruker	Før bruk	Kontroller at tiltingen går lett og lydløst, og at den låser i ønsket posisjon.
Kabler og kontakter	Bruker	Hver dag	Kontroller at de er uskadet.
Stabilitet og integritet	Bruker	Hver dag	Kontrollerat sengen er i god stand, stabil, og at alle deler fungerer tilfredsstillende.
Kanmed BabyWarmer	Bruker	Hver dag	Se Kanmed BabyWarmer bruksanvisning.
Hjul og bremseser	Bruker	Før bruk	Må sitte fast og låse.

7 Feilsøking

Symtom	Mulig feil	Hva bør gjøres
Løftesøylen beveger seg ikke, eller ikke som forventet. (Ikke for BB300 og BB400F)	Ikke strøm	Kontroller kabler, og at det er strøm i nettkontakten.
	Noe hindrer bevegelsen	Kontroller/fjern hindringer
	Elektrisk feil	Teknisk service
	Feil på fotpedal eller ikke tilkoblet	Teknisk service
Sengen kan ikke tiltes som normalt. Stopper i noen posisjoner. Låser ikke i valgt posisjon.	Feil på hydraulisk utløser	Teknisk service for justering.
	Noe hindrer bevegelse. Feil på gassfjær (ikke sannsynlig)	Fjern hindringer
Sengen er ustabil	Løse skruer eller hjul.	Teknisk service
Ulyder ved endring av høyde	Feil i løftesøyle	Teknisk service
Sideveggene går tregt.	Feil montering	Kontroller montering. Juster hjørnenes position

8 Tekniske data

	BB100 / 101/ 102* Standard BB300 / 301 Fixed height		BB400 / 401/ 402* Twin versions BB400F / 401F Fixed height	
Outer dimensions	With side rails L 85cm, W 63cm Med metallskinne B 58 cm*	Without side rails L 83cm, W 53cm	With side rails L 95cm W 80 cm Med metallskinne B 76 cm*	Without side rails L 93 cm W 70 cm
Bed Tray Inner dimensions	L690mm W465mm H90 mm Made of PP		L765mm W640mm H90mm Made of PP	
Height from floor of Bed Tray bottom	Min 78 cm Max 108 cm. Fixed height is 80cm Ordering 9,5 cm double wheels lowers all beds about 4 cm.			
Weight	About 46 kg Fixed height about 36 kg		About 52kg Fixed height about 42 kg	
Wheel base	64 cm X 87 cm			
Wheels	Diameter 125mm with brakes or 9,5 cm double wheels with brakes			
Tilt	About 17 degree. Option ± 17 degree			
Mattress	Soft foam coated			
Tent	Washable 60°C (90°C)			
Storage Box	L320mm W330mm H120mm, Lid 320x330mm			
Colors	Unisex light blue for all plastic details. Wheels and metal parts light grey			
Voltage BB100/400	230V 50Hz / 60Hz or 115V 60Hz, 150VA			
Fuses BB100/400	2xT6,3A 230V. Only replace with same type and rating			
Power outlet on Pillar BB100/101 /102 and BB400/401/402:	Max 300W			
Protection BB100/101/102/400/401/402:	Class I			

Produktforandringer ADVARSEL	Modifisering av Kanmed BabyBed er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra Kanmed. Kanmeds produktansvar opphører dersom et produkt modifiseres.
Opprette et system	Dersom noen tilkobler BabyBed til et annet produkts nettkontakt, kan det skapes et såkalt system ifølge IEC 60601-1. Den som evt. gjør dette må være kvalifisert til å vurdere evt. konsekvenser av denne sammenkobling, og om det kan skade pasient, bruker eller produkt.
Forventet brukstid på produktet	Kanmed garanterer en sikker brukstid på 10 år fra den dag produktet tas i bruk. Det er en forutsetning at produktet er blitt regelmessig vedlikeholdt ifølge bruksanvisning/teknisk manual, og at den ikke på noen måte er modifisert.

Produktet er CE-merket.

Tillatt omgivelsestemperatur

I bruk: +10 till + 40°C, <85% RH
 Transport: -20 to +60°C, ikke kondenserende.
 Lagring: +10 to +40°C, ikke kondenserende.
 Lufttrykk: 70 to 106 kPa

9 Technical Section - Service and Maintenance

NOTE: All spare parts used for replacement or repairs shall be supplied by Kanmed or its authorized distributor. The use of "non Kanmed permitted parts" will automatically reassign all safety responsibilities to the hospital. Only qualified personnel, biomed engineer or equivalent, shall attempt repairs. Do not attempt repairs with a patient in the bed.

9.1 Annual checks / maintenance

Check the following at least once a year:

- That cables and connectors free of defects.
- Check the Side Walls for cracks or damages.
- Check the Corners – no cracks in the plastic, screws tightened? Note, special plastic screws.
- Check the Side Wall Guides
- Check that the Side Walls lower and raise without problems and is easily lifted away.
- Check that the Foot Pedal for Pillar height control responds without delay, that the raising and lowering function is working correctly and that it makes no unusual noise when operated and that its cable is undamaged.
- Check that the tilt function works correctly. It should not make any noises.
- Check that the wire to the Gas Spring and tilt handle is undamaged.
- Check that the wheels are tightened to the stand and not damaged in any way, that they roll without noise, and that the wheel locking function works properly.
- Check that all screws are properly tightened, especially the screws connecting the height adjusting Pillar to the wheel base, the screws on top of the Pillar, the screws holding the Bed Platform and Gas Spring.
- Check that Foot Pedal Label is not worn
- Check that the Bed Tray Labels are not worn.

Service

NOTE

Always unplug the power before doing repair on the BabyBed.
Always make a complete function test after repairs.

9.2 Adjusting the release of the tilt function / Gas Spring

Hydraulic Tilt release

If the bed has mechanical tilt release then refer to version 1 of this manual for service information.

Available on www.kanmed.se.

It is a rather simple operation to upgrade to hydraulic tilt – contact your distributor.

By pressing the button you activate the release pin located at the top of the gas spring in the release head. If the tilt is not moving or not blocked by the gas spring then you must adjust the function.

Release the gas piston from the bracket on the pillar and release the locking nut at the release head (see picture)

Tilt is not moving: Turn (clockwise) the gas spring one turn inwards, insert gas piston in the bracket and push in the bolt. Test that it now moves freely and locks hard when the button is released.

The tilt is not locking: Turn (counterclockwise) the gas spring and test.

Make a final check. Then tighten the bolts and the locking nut.



9.2.1 Adjusting the tilt limit.

The tilt limit can be limited by moving down the Gas Spring holder bracket on the Pillar. Make sure to tighten it properly.

9.3 Changing or adjusting a Side Rail or Corner

See spare part list for part numbers. The Side Rail Corners are screwed from the underside with two (2) special plastic screws at each Corner. The holes in the Bed are oval allowing a tight adjustment of the Side Rails. It is advisable to remove the screws at min 2 Corners to fit new Corners or Side Rails.

Do not use any other screws than Kanmed part no 700-0880 because they will not have enough holding power. A screw can be screwed in and out about 6 times in the same plastic hole.

9.4 Adding, removing or adjusting Storage Boxes

Loosen the screws to the Storage Box Holder. Move it to the new position and tighten the screws properly.

To remove or add an extra Box Holder: Raise the Pillar more than 5 cm. Press down the black plastic frame that goes around the bottom of the Pillar. Now you can remove the bolt pins or add bolt pins.

When adding Storage Boxes ensure that the Front Side Wall can be lowered sufficiently.

NOTE: The aluminum pin must be inserted through the box before bolting it to the bracket.

9.5 Changing the Foot Pedal / electrical connections

Lay the Bed carefully on its side. Unplug the pedal from the Pillar. Unscrew the Foot Pedal and replace it. Raise the Bed and check functions and that up / down arrows are indicating correct.

9.6 Changing the Pillar

Raise the Pillar electrically about 5 cm if possible.

Unplug power.

Empty the Bed and remove side walls and the Baby Tray.

Remove Storage Boxes. Press the plastic frame at the bottom of the Pillar down. Peel away the plastic strips so that you can remove the metal pins that hold accessories to the Pillar. If Pillar could not move then you will have to order new metal pins.

Remove Gas Spring from the Pillar as well as its bracket.

Loosen the bolts that hold the Bed Platform. Don't forget the earth cable.

Loosen the bolts on top of the Pillar to remove the Bed bracket. Observe the earth cable on the underside.

Unplug the height control.

Turn the Pillar/Bed upside down.

Unscrew the earth potential stud connections.

Remove the earth protection cable under the Bed.

Loosen screws under the wheel base and remove the foot pedal.

Unscrew the Pillar. Observe the earth cable

To assemble - redo in reverse order.

Make a full function check and an electrical safety test to ensure that the Bed Platform is properly grounded.

10 Tillbehør / reservedeler

Art. No.	Product	Additional information
BB112	Under bed BabyWarmer holder	A kit includes complete instruction. Requires a 7mm metal drill on beds before 2018. Also specify if it is for single or twin beds. BW3 may require bracket holder BW3-0837.
800-0116	Side wall rear BB101/301/102	Height 25cm. Beds without side rails. Groves for tubing.
800-0117	Side wall rear BB401/401F/402	Height 29cm. Beds without side rails. Groves tube from above.
800-0118	Side wall rear BB100/BB300	Height 25cm. Groves for tubing.
800-0119	Side Wall rear BB400/400F	Height 29cm. Groves for tubing.
800-0010	Side wall rear BB100/BB300.	Height 29 cm, Grooves for tubing
800-0105	Side wall rear BB101/BB301/102	Height 25 cm. For beds without side rails only groves for tubing
800-0042	Side Wall rear BB400/400F	Height 29 cm. Grooves for tubing
800-0109	Side wall rear BB401/401F/402	Height 25 cm For beds without side rails. Groves for tubing from side.
800-0077	Side wall left/right BB100/BB300	Height 29 cm
800-0101	Side wall left/right BB101/BB301/102	Height 25 For beds without side rails only
800-0079	Side wall left/right BB400/BB400F	Height 29 cm
800-0107	Side wall left /right BB401/401F	Height 25 For beds without side rails only
800-0076	Side wall front BB100/BB300	Height 29 cm
800-0100	Side wall front BB101/BB301	Height 25 cm For beds without side rails only
800-0078	Side wall front BB400/BB400F	Height 29 cm
800-0108	Side wall front BB401/401F	Height 25 cm For beds without side rails only
800-0072	Side wall stop red	Set of 4 pcs
800-0023	Side Rail front/rear BB100/BB300	Length 40 cm
800-0022	Side Rail sides BB100/BB300	Length 62 cm
800-0044	Side Rail front/rear BB400/BB400F	Length 57,7 cm
800-0045	Side Rail sides BB400/BB400F	Length 72,3 cm
800-0110	Corner BB100-400	Incl. 2 screws and cover under handle. For beds with siderails.
800-0098	Corner Handle BB101-401	Incl. 2 screws. For beds with metal rails and without siderails
700-0880	Screws for Corner Bracket	Use only this special screw for plastic corners
800-0004	Baby Tray BB100/BB300	Also for BB101/301/102
800-0041	Baby Tray BB400/BB400F	Also for BB401/401F/402
800-0002	Storage Box	For all bed models
800-0013	Storage Box holder	Includes set of bolt pin and screws
800-0001	Storage Box lid	For all beds
800-0003	Wheel top Cover	For all beds
800-0501	Foot Pedal	For replacement. With cable and label. Bracket not included.
800-0029	Bolt pin for pillar accessories.	Dia 7 mm, L 30 mm Screw M5. Including the screw.
700-0874	Wheel incl. bolt and bracket, with brake.	Standard on all beds
700-0884	Double wheel 95mm, lockable	Optional.
800-0048	Electrical pillar 230V	For BB100 to 401F beds only
800-0526	Electrical pillar 115 V	For BB100 to 401F beds only
800-0506	Gas spring	For beds with standard +17° tilt
BB172	Hydraulic tilt kit	Includes release hydraulic mechanism, button, bracket and dome nuts. For up grading beds with mechanical tilt.
800-0519	Hydraulic gas spring control unit	Replacement for faulty hydraulic gas spring release
800-0528	Release button (black)	Pack of 5pcs. Must be secured with Lock-Tite, glue
800-0520	Locking handle	To be used with 800-0527

Tilbehør Baby Beds BB100/101/102, 300/301/302, 400/401/402, 400F/401F

Art.no	Product	Additional Information
BB155	Foam Mattress	For BB100-301. Sealed, easy to clean.
BB450	Foam Mattress	For BB400-401F. Sealed, easy to clean.
BB161	Tent BabyBed	For BB100-301. Pink/Beige.
BB160	Tent BabyBed	For BB100-301. Yellow/Terracotta.
BB162	Tent BabyBed	For BB100-301. Yellow/Blue.
BB460	Tent BabyBed twin	For B400-401F. Yellow/Terracotta.
BB170	Storage Box complete	Storage box with lid. Including necessary brackets and screws.
BB180	Metal Shelf, low complete	Metal shelf with lid. Including necessary brackets and screws. 33x33x3cm
BB190	Metal Shelf, high complete	Metal shelf with lid. Including necessary brackets and screws. 33x33x5cm
800-0518	Drip pole	Length 650mm, diameter 25mm. Including locking handle. For Kanmed Babywarmer bracket or other equipment
800-0502	Power cable for BabyWarmer	Special power cable (1m) that connects power to the Kanmed BabyWarmer, all models. Using the power outlet on the pillar under the bed tray.
BB171	Bottle Holder	Stainless steel bracket for mounting of hand disinfection bottles. Max diameter 70-80 mm.
BB173	Trendeleburg kit ($\pm 17^\circ$ tilt)	Includes special gas spring and top plate.
BB175	Fot pedal kit Left/right	Includes bracket cable and foot pedal
BB176	Fot pedal front mount	Includes front bracket, extra cable and foot pedal

OBSERVER: Andre reservdeler og tilbehør kan finnes. Sjekk på Kanmed hjemmesider www.kanmed.se
Der vil du også kunne finne seneste utgave av Brukermanualen.

11 Garantier

Kanmed garanterer at BabyBed skal være feilfri i en periode på **5år** fra innkjøpsdato dersom annet ikke er skriftlig avtalt. Garantien dekker ikke sidevegger, plastdetaljer som hjørner samt madrasser og telt. Ved feil i garantiperioden kan Kanmed selv bestemme:

- Om enheten skal repareres med nye eller innbyttedeler
- Bytte av enhet eller deler av den mot likeverdig utstyr
- Ta enheten i retur mot tilbakebetaling.

Garantien gjelder ikke dersom produktet:

- har blitt modifisert, justert eller reparert uten Kanmeds godkjenning
- har blitt modifisert, justert eller reparert på annen måte enn anbefalt fra Kanmed
- har blitt brukt feil, eller på annet vis blitt skadet

Denne garantien gjelder kun dersom feilen er meldt til Kanmed i garantiperioden. Kanmed tar ikke ansvar for skader som oppstår etter feilaktig bruk, ikke godkjente modifiseringer, eller brudd på sikkerhetsbestemmelser.

12 EMC Information

Kanmed BabyBed Oppfyller relevante deler av standard IEC 60601-1-2:2007 Electromagnetic compatibility (EMC).

Kanmed BabyBed skal brukes i sykehusmiljø, men ikke nært diatermiutstyr eller nært MR utstyr.

ADVARSEL: Bruk av kabler eller tilbehør som ikke er spesifisert av Kanmed kan resultere i økt elektromagnetisk stråling eller redusert immunitet, noe som kan påvirke funksjonen.

ADVARSEL: Bærbare enheter som avgir radiosignaler, som mobiltelefoner og modem, skal ikke brukes nærmere enn 30 cm fra sengen da dette kan påvirke funksjonen.

OBSERVER: Utstrålt energi fra denne enhet gjør den egnet for bruk i industriell eller sykehusmiljø (CISPR 11 class A). Om den brukes i hjemmemiljø eller lignende, er det en mulighet for at den ikke er tilstrekkelig skjermet mot eksterne radiosignaler. Brukeren må evt. flytte enheten.

For ytterligere informasjon om tilpasning til den spesifiserte EMC standard, test nivåer etc, kan Kanmed kontaktes.

13 Kassering



Når Kanmed BabyBed skal kasseres skal den leveres til gjenvinning ifølge 2012/19/EU (WEEE) direktivet.

KANMED^o BABYBED



KANMED^o
a MedCare Visions® company

Hammarbacken 6A, 191 49 Sollentuna
Sweden

Telefon +46 8 56 48 06 30

E-Mail: info@kanmed.se

Hjemmeside: www.kanmed.se

Distributør:
Medu Norge AS
Biskop Jens Nilssøns gate 5
0659 Oslo

Hjemmeside:
www.medu.no